



メーカー校正サンプル

試験成績書

品名 : WATCH LOGGER
 形式 : KT-****
 製造番号 : AZ-*****

株式会社 藤田電機株式会社
 〒259-1132
 神奈川県伊勢原市
 桜台2丁目25番4号
 TEL 0463-95-1221
 FAX 0463-95-1225

承認	担当

試験成績

温度精度測定 試験年月日 20**/**/** 温度24.2℃、湿度32%RH

測定項目	校正値(℃)	許容下限値(℃)	表示値(℃)	許容上限値(℃)
温度	25.1	24.1	25.0	26.1

湿度精度測定 試験年月日 20**/**/** 温度24.2℃、湿度32%RH

測定項目	校正値(%)	許容下限値(%)	表示値(%)	許容上限値(%)
湿度	30.3	29.2	31.6	30.2

使用標準器

温度湿度計
 形式番号 : HM70(MI70/HMP77)
 ・ 製造番号 : MI70D1530064/HMP77D1830005
 ・ 有効期限 : 20**年**月

試験成績書

校正証明書

発行番号: 2000*****
 発行日: 20**年**月**日

発注顧客 : 株式会社***** 殿

品名 : WATCH LOGGER
 型式 : KT-****
 製造番号 : 下記製造番号の製品
 試験年月 : 20**/**/**
 試験環境 : 温度24.2℃、湿度32%RH

株式会社 藤田電機株式会社
 〒259-1132
 神奈川県伊勢原市
 桜台2丁目25番4号
 TEL 0463-95-1221
 FAX 0463-95-1225


製造番号 A2-20110186001880

上記の製品は、国家標準にトレーサされた標準器を基準にした測定体系の基で校正が行われた測定器を使用し、当社の校正業務に基づき校正された規格を満足していることを証明します。

照合用標準器

機器名称	製造者	型式	製造番号	校正有効期限
温度湿度計(指示部)	グワイテラ(株)	MI70	D1830064	2017年6月
温度湿度プローブ	グワイテラ(株)	HMP77	D1830006	2017年6月

校正証明書

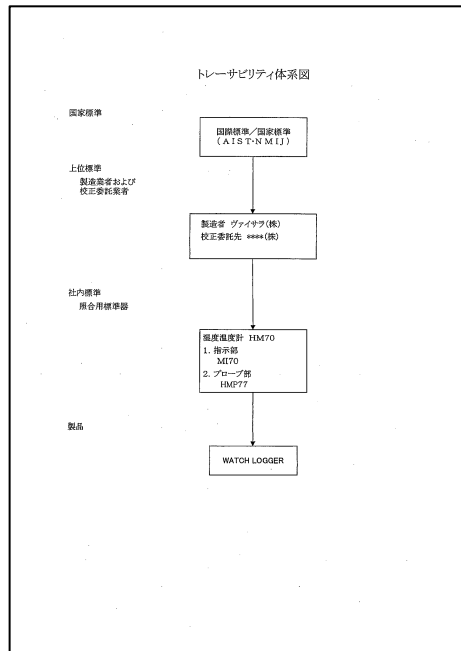

トレーサビリティ